FORA® G31
福爾益康背光型血糖機

簡易使用說明書

福爾係經美商 Fora Care Inc.監製，並授權商標使用與販售。
製造廠名稱：泰博科技股份有限公司五股廠
製造廠地址：新北市五股區五工二路127號B1-7樓
藥商名稱：泰博科技股份有限公司
藥商地址：新北市五股區五工二路127號6樓
福爾台灣網址：www.foracare.com.tw
客戶服務專線：0809-007-868［週一 ~ 週五 9:00-18:00］

其它時間，請聯繫您的醫療保健專業人士的援助。

CE 0123 IVD For self-testing.

315-4256000-008

親愛的福爾益康背光型血糖機使用者您好：

感謝您選用福爾益康背光型血糖機。本產品提供您測量血糖；準確的測試結果，讓您可以放心的和醫師一同監控血糖值的變化。本產品操作簡便，適用於居家健康管理。

在您使用福爾益康背光型血糖機，簡易使用說明書能輔助您快速了解福爾益康背光型血糖機的操作方式；若您想知道關於此機器更進一步詳細資訊，敬請詳細閱讀使用說明操作手冊。

效能:本產品為體外診斷醫療器材，必須使用新鮮的指尖全血。適用於糖尿病患自我量測及監控血糖，但新生兒除外。除指尖外，尚可使用其他部位血樣進行血糖測試，包括手掌、前臂、上臂、小腿與大腿。

機器正面

TD-4256A

TD-4256B

機器背面

產品介紹

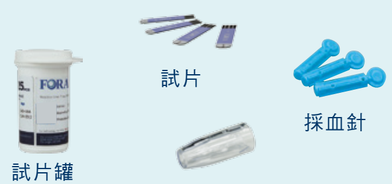

採血筆

1.機器設定

1-1

進入設定模式 ：
按設定鍵即進入設定模式。
年份首先閃爍

1-2

按記憶鍵(M鍵)改變參數調整數字直到正確。
按設定鍵(SET鍵)進入下一個欲調整之選項。

1-3

依前面 1-2 步驟來執行，
畫面依次會出現：
1.月份/日期
2.小時(AM上午　PM下午)/分鐘
3.記憶刪除功能(刪除所有記憶)
4.鬧鈴功能
(設定4組時間on為開啟OFF為關閉)
5.當您完成設定，按一下設定鍵，
機器自動關機。

2.採血設備

2-1

取下採血筆蓋。

2-2

請用大拇指輕掐住「採血針置入處」凹槽部位，再將採血針『完全套入到底 』，確定緊固。

2-3

旋轉取下採血針針頭護蓋。

2-4

將採血筆蓋套回並固定。

2-5

刻度線條越長，扎入深度越深
詳細內容請見福爾益康背光型血糖機。

2-6

雙手握住筆蓋及筆桿並往後拉，使產生”喀”一聲，此時, 按鈕內的顏色會產生變化，代表設定完成，完成後請置於一旁備用。

3.血糖量測

試片開封，請先於瓶身記下首次開瓶日期。開封後於90天內使用完畢。

3-1

取出試片前，請拭乾雙手；試片取出後，並立即蓋上試片罐蓋。

3-2

將試片插入機器。
螢幕依序顯示CHK及 ▭ →
閃爍的 "💧"、編碼及號碼、『一般』。
按記憶鍵 (M鍵) 完成選擇測試模式
(一般/ 🍎 飯前/ 🍸 飯後)。

3-3

核對密碼
比對試片瓶號碼是否和機器上所顯示的號碼相同，如果不相同，
請聯繫當地經銷商。

3-4

輕輕按摩採血部位。以酒精棉片消毒後，待酒精揮發完全。將採血筆牢牢抵住要採血的位置；按下按鈕聽到喀聲時代表採血已經完成。

3-5

輕輕地擠壓穿刺的周邊部位以取得足夠的血液。

3.血糖量測

3-6

機器上的〝💧〞閃爍時，將試片吸入口以45度靠近血液，血液會被吸入，停留約2秒後，待吸入口的反應區內吸滿血量後，再移開。

3-7

機器開始倒數到0完成後，結果會出現於螢幕，所得數值會自動被記憶。

3-8

拔下採血筆蓋，將針頭刺入採血針針頭護蓋，
一手往前推動採血針，一手輕拉後端拉桿，推出採血針。

請注意:採血針請勿重複使用或與他人共用, 避免交互感染
請依當地法令規定丟棄使用過的試片及採血針。

3-9

退出試片，機器會自動關機。

4.量測結果輔助指示

依據2008年美國糖尿病協會建議，糖尿病病人及正常人應盡量將血糖控制在標準血糖值範圍，如下表所示：

時段狀態	血漿血糖值範圍	
	正常人血糖值*1	糖尿病控制目標值*2
空腹或餐前	<100 mg/dL	70-130 mg/dL
飯後 2 小時	<140 mg/dL	<180 mg/dL

資料來源: *1 American Diabetes Association (2008). Clinical Practice Recommendations. Diabetes Care, 31 (Supplement 1): S1 -108
*2 American Diabetes Association (2008). Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care, 31 (Supplement 1): S12-S54.

請注意:上述範圍僅供參考，請諮詢醫護人員關於適合您的血糖值範圍。

4.量測結果輔助指示

圖示	血糖值範圍	螢幕說明
181 飯前 高	飯前血糖 >130mg/dL	“過高”同時伴隨『🍎 飯前』的標示會出現螢幕。
45 飯前 低	飯前血糖值<70 mg/dL	“過低”同時伴隨『🍎 飯前』的標示會出現螢幕。
181 飯後 高	飯後血糖值>180 mg/dL	“過高”同時伴隨『🍸 飯後』的標示會出現螢幕。
45 飯後 低	飯後血糖值<70 mg/dL	“過低”同時伴隨『🍸 飯後』的標示會出現螢幕。
--- 飯前 高	飯前血糖值低於量測範圍20 mg/dL	“過低”同時伴隨『🍎 飯前』的標示會出現螢幕。建議您此時應立即與專業醫護人員連絡。
--- 飯前 高	飯前血糖值高於量測範圍600 mg/dL	“過高”同時伴隨『🍎 飯前』的標示會出現螢幕。建議您此時應立即與專業醫護人員連絡。
--- 飯後 低	飯後血糖值低於量測範圍20 mg/dL	“過低”同時伴隨『🍸 飯後』的標示會出現螢幕。建議您此時應立即與專業醫護人員連絡。
--- 飯後 高	飯後血糖值高於量測範圍600 mg/dL	“過高”同時伴隨『🍸 飯後』的標示會出現螢幕。建議您此時應立即與專業醫護人員連絡。
--- 一般 低	一般情況下，血糖值低於量測範圍20 mg/dL	“過低”同時伴隨『一般』的標示會出現螢幕。建議您此時應立即與專業醫護人員連絡。
--- 一般 高	一般情況下，血糖值高於量測範圍600 mg/dL	“過高”同時伴隨『一般』的標示會出現螢幕。建議您此時應立即與專業醫護人員連絡。