FORA®
福爾

型號: TD-1115
衛部醫器製字第006758號
使用前請務必詳閱原廠之使用說明書，並遵照指示使用

舒康額溫槍
Comfort Forehead Thermometer

親愛的使用者 您好：

感謝您購買福爾舒康額溫槍。

請使用包裝內所附的保證卡與經銷商註冊，以便日後維修與售後服務。若您對本產品有其他疑問，請直接連絡當地經銷商或是購買地點。

產品外觀

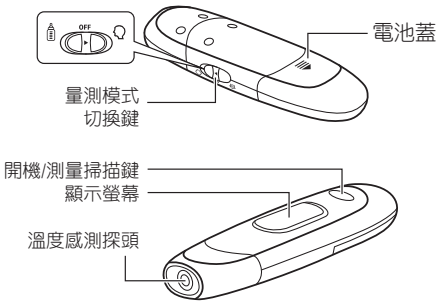

預期用途

本產品採用紅外線量測技術測得人體額頭溫度。

本產品亦可偵測物體表面溫度。(此非屬醫療器材效能)

顯示螢幕

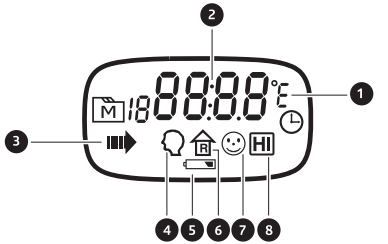

1. 溫度單位
2. 測量結果顯示區
3. 溫度掃描中
4. 額溫測量模式
5. 電池符號
6. 表面測量模式
7. 測量結果指示(正常)
8. 測量結果指示(高溫)

選擇溫度單位



1. 將測量模式切換到額溫，立即按住掃描鍵不放。



2. 長按掃描鍵3-4秒後，顯示螢幕會出現SET字樣。



3. SET字樣出現後，按掃描鍵切換單位攝氏(°C)或華氏(°F)。



4. 選定欲使用的單位後，再次長按掃描鍵3-4秒，直到螢幕出現額溫量測模式的符號，表示溫度單位設定完成。

量測注意事項



1. 將溫度感測探頭穩定放置於額頭前方2-3公分處。額頭若有覆蓋瀏海或其他物品需撥開，否則可能影響量測結果的準確度。



2. 量測完成後，將量測模式切換鍵切到OFF即可關機。

執行量測

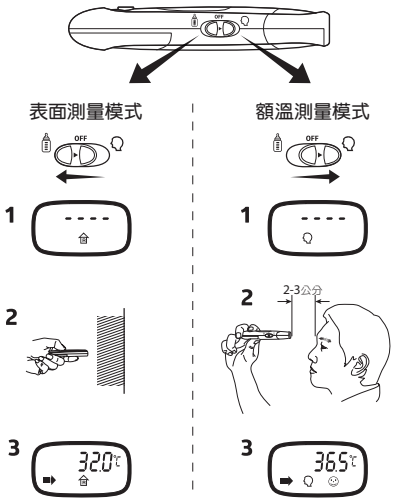

請注意: 在表面測量模式下，按住掃描鍵不放可連續測量表面溫度。

量測結果指示

☺	表示測量溫度落在 34.4°C~37.9°(93.9°F~100.2°F)，螢幕顯示綠色背光。
Hi	表示測量溫度落在 38.0°C~42.2°(100.4°F~108°F)，螢幕顯示紅色背光。
Hi / Lo	表示測量溫度超過可量測範圍。 Hi 表示溫度高於42.2°C(108°F)， Lo 表示溫度低於34.4°C(93.9°F)，螢幕顯示藍色背光。

福爾係經美商Fora Care Inc.監製，
並授權商標使用與販售。
製造廠名稱：泰博科技股份有限公司五股廠
製造廠地址：新北市五股區五工二路127號B1-7樓
藥商名稱：泰博科技股份有限公司
藥商地址：新北市五股區五工二路127號6樓
福爾台灣網址：www.foracare.com.tw
客戶服務專線：0809-007-868
(週一~週五09:00-12:00 13:30-18:00)
其他時間，請聯繫您的醫療保健專業人士取得協助。

更換電池



1. 打開電池蓋



2. 請將電池蓋取下，並使用電池蓋底部勾勾將電池取出。



3. 請使用1顆3V CR2032鋰電池，將電池置入電池座



4. 蓋回電池蓋

故障訊息排除

螢幕顯示	可能原因	解決方法
Err1 Err2	環境溫度超出範圍	請在10°C至40°C(50°F至104°F)的環境溫度下操作機器。
Err4	機器內部發生問題	請重新測試一次。若仍無法解決問題，請與當地經銷商聯繫。
	電池電壓過低	請盡快更換新的電池。
Err5	電力低至無法執行量測，機器將自動關機。	立即更換新的電池。

警告與注意事項

1. 使用之前，務必檢查溫度感測探頭部位的清潔，必要時，請使用乾淨、乾燥的棉花棒擦拭並清潔內側的探頭。
2. 人體溫度無絕對標準值，請於日常測量並記錄正常體溫值，在懷疑發燒時請將測量結果與平時個人的正常範圍告知醫師，並由醫師進行發燒的判斷。
3. 人體各部位的溫度各有不同，因此在不同部位測得的體溫數值不應直接比較。
4. 對測量結果請勿自我判斷和治療，請諮詢並遵照醫師指示。
5. 避免機器摔落及用力碰撞。
6. 請勿自行拆卸、修理和改造機器，否則可能導致測量結果出現誤差或引起機器故障。
7. 本產品無防水功能。使用時請小心，避免任何液體進入，切勿將產品放在水龍頭下方沖洗或浸泡在水中。
8. 應隨時採取基本的安全防護措施，特別是使用於兒童或行動不便人士或在其附近使用時。
9. 本產品的操作溫度範圍在10°C至40°C之間(50°F至104°F)，相對濕度30~85%。
10. 請將本產品存放在陰涼乾燥的地方，-20°C至60°C(-4°F to 140°F)，相對濕度30~85%。

清潔保存注意事項

- 機體請盡量以乾布擦拭即可。
- 使用前請用乾棉花棒清潔探頭鏡面。
- 避免將機器長期暴露於高溫下，如直接日照下之汽車內。
- 避免機器掉落及用力碰撞，探頭鏡頭請避免手指觸摸、並請勿自行拆卸。

產品規格

型號	TD-1115
尺寸及重量	127.75(L) x 37.7(W) x 20.76(H)mm, 56.2g(不含電池)
電源	1 顆 3V CR2032鋰電池
顯示溫度範圍 (人體測量模式)	34.4°C to 42.2°C (93.9°F to 108°F)
顯示溫度範圍 (表面測量模式)	1°C to 60°C (33.8°F to 140°F)
解析度	0.1 °F/0.1°C
準確度 (人體測量模式)	±0.2°C (±0.4°F)，35.0°C (95.0°F)至42.0°C(107.6°F); ±0.3°C (±0.5°F)，<35.0°C (95.0°F)或>42.0°C(107.6°F)
溫度單位	°C(預設) 或 °F
操作環境溫度	10°C至40°C (50°F至104°F)
操作環境濕度	相對溼度30~85%
保存環境溫度	-20°C至60°C (-4°F至140°F)
保存環境濕度	相對溼度30~85%
防水防塵等級	IP22

311-1115300-017